
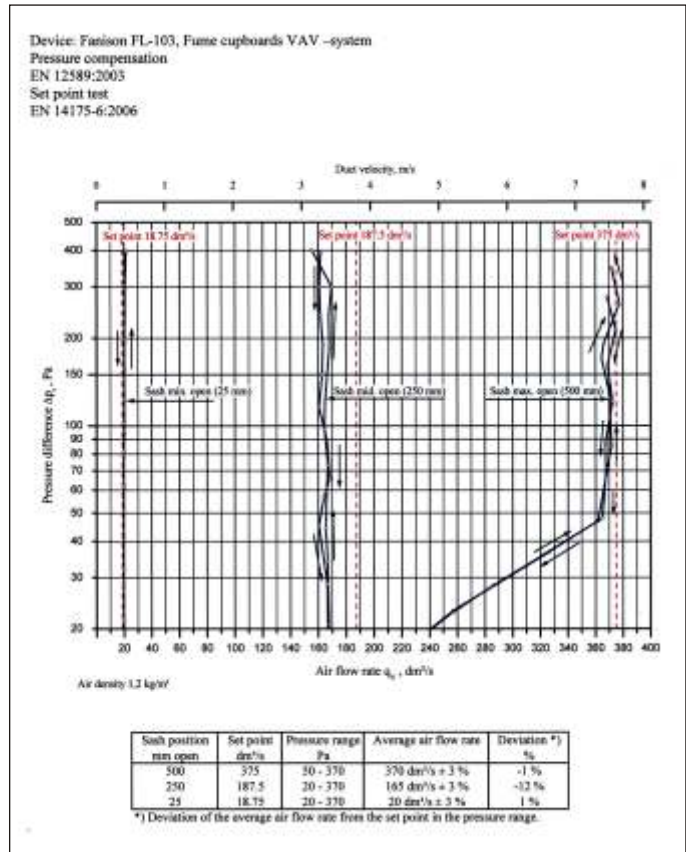



Mittaustulokset EN 14175-6 mukaisesti testatusta Fanison FL 103 vetokaappien otsapintanopeuden säätöjärjestelmästä

Yhteenvetotaulukoista nähdään säätöjärjestelmän toiminta erilaisilla kanavapaineilla, säädöntarkkuus ja vasteajat standardin mukaisesti mitattuina.

Testit on tehty standardin mukaisella mallivetokaapilla, jonka minimi ilmavirta oli 18,75 l/s , maksimi ilmavirta 375 l/s ja luukun nosto-/laskuaika 1 sekunti.

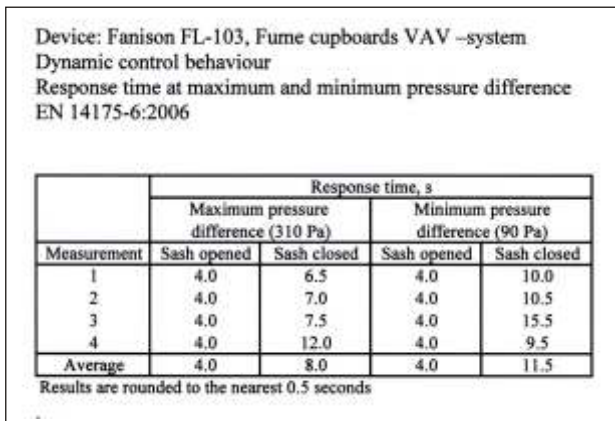

Esimerkkinä vasteaikamittaus nro 3 maksimi paine-erolla

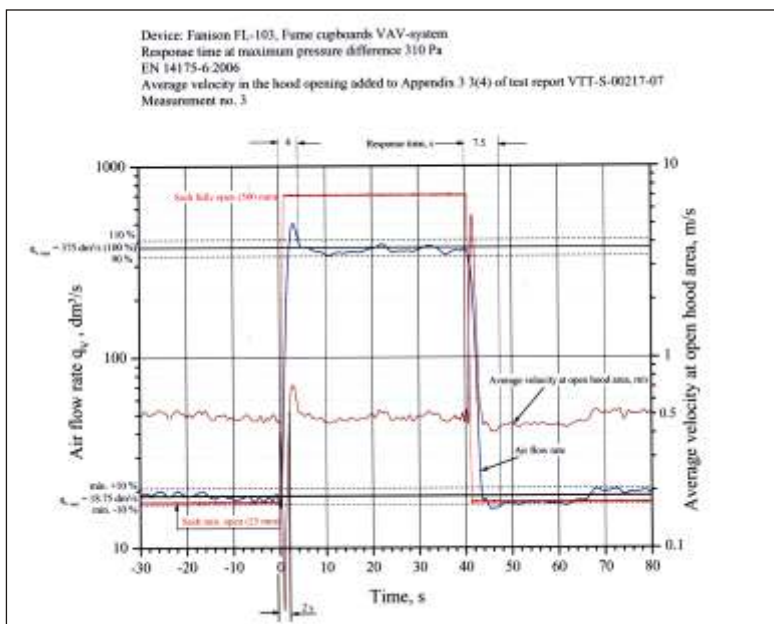

VTT:n testiraportti VTT-S-00217-07 / 5.1.2007 on pyynnöstä saatavilla ottamalla yhteyttä takasivun yhteystietoihin .